### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-070384

(43)Date of publication of application: 18.03.1997

(51)Int.CI.

A61B 1/06

(21)Application number: 07-241104

(71)Applicant:

**ASAHI OPTICAL CO LTD** 

(22)Date of filing:

20.09.1995

(72)Inventor:

**SANO HIROSHI** 

**ADACHI RIYUUSUKE** 

(30)Priority

Priority number: 06226522

Priority date: 21.09.1994

Priority country: JP

07164950


30.06.1995

#### (54) ELECTRONIC ENDOSCOPIC APPARATUS FOR FLUORESCENT DIAGNOSIS

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the title electronic endoscopic apparatus capable of obtaining a sufficiently bright fluorescent image by the fluorescence emitted from a living body.

SOLUTION: An ultrahigh sensitivity solid-state imaging element is arranged at the image forming position of a subject by the object optical system 4 provided to the leading end of an insertion part 1 and a fluorescence transmitting filter 6 having a transmission region on the wavelength side longer than that of the light exciting the fluorescence from living body tissue is arranged in front of the ultrahigh sensitivity solid-state imaging element 2.



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

# 特開平9-70384

(43)公開日 平成9年(1997)3月18日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
A 6 1 B	1/04	372		A 6 1 B	1/04	372	
	1/06				1/06	Α	

## 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)


(32)優先日 平6 (1994) 9 月21日 学工業株式会社内   (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 安遠 施介   (31)優先権主張番号 特願平7-164950 東京都板橋区前野町 2 丁目36番 9 号   (32)優先日 平7 (1995) 6 月30日 学工業株式会社内	21)出願番号	<b>特願平</b> 7-241104	(71)出顧人	000000527
(31) 優先権主張番号 特願平6-226522 東京都板橋区前野町 2 丁目36番 9 号 (32) 優先日 平 6 (1994) 9 月21日 学工業株式会社内 (33) 優先権主張番号 特願平7-164950 東京都板橋区前野町 2 丁目36番 9 号 (32) 優先日 平 7 (1995) 6 月30日 学工業株式会社内				旭光学工業株式会社
(31) 優先権主張番号 特願平6-226522 東京都板橋区前野町 2 丁目36番 9 号 (32) 優先日 平 6 (1994) 9 月21日 学工業株式会社内 (33) 優先権主張国 日本 (JP) (72) 発明者 安達 流介 (31) 優先権主張番号 特願平7-164950 東京都板橋区前野町 2 丁目36番 9 号 (32) 優先日 平 7 (1995) 6 月30日 学工業株式会社内	22) 出願日	平成7年(1995)9月20日		東京都板橋区前野町2丁目36番9号
(32) 優先日 平6 (1994) 9 月21日 学工業株式会社内   (33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 安達 淹介   (31) 優先権主張番号 特願平7-164950 東京都板橋区前野町2丁目36番9号   (32) 優先日 平7 (1995) 6 月30日 学工業株式会社内			(72)発明者	佐野 浩
(33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 安達 淹介   (31) 優先権主張番号 特願平7-164950 東京都板橋区前野町2丁目36番9号   (32) 優先日 平7(1995) 6月30日 学工業株式会社内	31)優先権主張番号	特顏平6-226522		東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光
(31) 優先権主張番号 特願平7-164950 東京都板橋区前野町 2 丁目36番 9 号 (32) 優先日 平 7 (1995) 6 月30日 学工業株式会社内	32)優先日	平6 (1994) 9 月21日		学工業株式会社内
(32) 優先日 平 7 (1995) 6 月30日 学工業株式会社内	33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	安達一滝介
(32) 優先日 平 7 (1995) 6 月30日 学工業株式会社内	31)優先権主張番号	特願平7-164950	ļ	東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光
	32)優先日	平7 (1995) 6 月30日		
(33)優先権主張国 日本(JP) (74)代理人 弁理士 三井 和彦	33)優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人	<b>弁理士</b> 三井 和彦
(33) 優先権主張国 日本(JP) (74) 代理人 弁理士 三井 和彦	31) 優先権主張番号 32) 優先日	特願平7-164950 平7(1995)6月30日		東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭学工業株式会社内

### (54) 【発明の名称】 蛍光診断用電子内視鏡装置

#### (57)【要約】

【課題】生体から発せられる蛍光により充分に明るい蛍 光像を得ることができる蛍光診断用電子内視鏡装置を提 供すること。

【解決手段】挿入部1の先端に設けられた対物光学系4による被写体の結像位置に超高感度画体撮像素子2を配置して、その超高感度固体撮像素子2の前方に、生体組織から蛍光を励起させる励起光の法長より長波長側に透過領域を有し且つ上記励起光は透過しない特性を有する蛍光透過用フィルタ6を配置した。

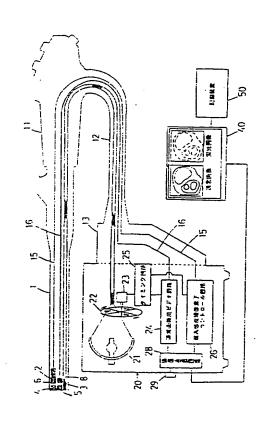

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】挿入部の先端に設けられた対物光学系による被写体の結像位置に超高感度固体撮像素子を配置して、その超高感度固体撮像素子の前方に、生体組織から蛍光を励起させる励起光の波長より長波長側に透過領域を有し且つ上記励起光は透過しない特性を有する蛍光透過用フィルタを配置したことを特徴とする蛍光診断用電子内視鏡装置。

1

【請求項2】上記蛍光透過用フィルタか略480nmないし600nmの範囲の波長の光だけを透過する請求項 101記載の蛍光診断用電子内視鏡装置。

【請求項3】上記超高感度固体撮像素子が、上記対物光学系により結像した光像が光電変換されて生じる電子をアモルファスシリコン積層アンプリファイドMOSイメージャーに当てて電子数を増大させるものである請求項1又は2記載の蛍光診断用電子内視鏡装置。

【請求項4】上記超高感度固体撮像素子が、イメージインテンシファイア付きの固体撮像素子である請求項1又は2記載の蛍光診断用電子内視鏡装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、生体組織に対して特定波長の励起光を照射して、生体組織自体から発せられる蛍光を観察することにより早期癌などを発見するための蛍光診断用電子内視鏡装置に関する。

[0002]

【従来の技術】生体組織に対して波長400nmないし480nmの光(励起光)を照射すると、正常な組織は略480nmないし600nmの範囲の蛍光を発し、癌細胞は蛍光を発しないので、通常の内視鏡観察ではよく分からないような早期癌を発見し得ることが知られている。

【0003】そこで、従来の蛍光診断用電子内視鏡装置においては、例えば特開平4-150845号公報に記載されているように、挿入部の先端に設けた対物光学系による被写体の結像位置に固体撮像素子を配置して、その固体撮像素子の前方に略500nmないし600nmの範囲の波長の光だけを透過する蛍光透過用フィルタを配置している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし励起光の照射によって生体が発する蛍光は非常に弱いものなので、、上述のような従来の蛍光診断用電子内視鏡装置の構成では、充分な明るさの蛍光画像を得ることができず、的確な診断を下すことができない場合が多かった。

【0005】そこで本発明は、生体から発せられる蛍光により充分に明るい蛍光像を得ることができる蛍光診断用電子内視鏡装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた 50

め、本発明の蛍光診断用電子内視鏡装置は、挿入部の先端に設けられた対物光学系による被写体の結像位置に超高感度固体撮像素子を配置して、その超高感度固体撮像素子の前方に、生体組織から蛍光を励起させる励起光の波長より長波長側に透過領域を有し且つ上記励起光は透過しない特性を有する蛍光透過用フィルタを配置したことを特徴とする。

【0007】なお、上記蛍光透過用フィルタが略480 nmないし600 nmの範囲の波長の光だけを透過するようにしてもよい。また、上記超高感度固体撮像素子が、上記対物光学系により結像した光像が光電変換されて生じる電子をアモルファスシリコン積層アンプリファイドMOSイメージャーに当てて電子数を増大させるものであってもよく、或いは、上記超高感度固体撮像素子が、イメージインテンシファイア付きの固体撮像素子であってもよい。

[0008]

【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図2は、実施の形態装置の全体構成の外20 観を示し、図1はその内部構造の概略を示している。

【0009】可撓性のある内視鏡の挿入部1の先端には、図3に拡大図示されているように、超高感度固体撮像素子2と通常の固体撮像素子3とが、共に前方に向けて並んで配置されている。

【0010】固体撮像素子3としては、例えばモノクロ 用の電荷結合素子(CCD)が用いられ、超高感度固体 撮像素子2としては、例えば光像が光電変換されて生じ る電子をアモルファスシリコン積層アンプリファイドM OSイメージャーに当てて電子数を1000倍以上に増 大させる方式のものを用いることができる。

【0011】超高感度固体撮像素子2と固体撮像素子3 の前方には各々対物光学系4、5が配置されていて、挿入部1の前方の被写体の像が超高感度固体撮像素子2と 固体撮像素子3とに結像される。なお、超高感度固体撮 像素子2と固体撮像素子3とが、一つの対物光学系を共 用するように構成してもよい。

【0012】第1の対物光学系4と超高感度固体撮像素子2との間には、520nmないし600nmの波長の光だけを透過する蛍光透過用フィルタ6が配置されている。固体撮像素子3の前方にはそのようなフィルタは配置されていない。

【0013】また、両対物光学系4,5の観察範囲に向けて照明光を照射する照明用ライトガイドファイババンドル8の射出端が、両対物光学系4,5と並んで配置されている。

【0014】図4は、挿入部1の先端面の正面図であり、4aと5aは対物光学系4.5が配置された観察窓、8aは、照明用ライトガイドファイババンドル8の射出端が配置された照明窓、9は、処置具類の突出口である。



10

20

【0015】図1及び図2に戻って、挿入部1の基端は 操作部11に連結されており、その操作部11に連結さ れた連結可撓管12の先端には、ビデオプロセッサ20 に接続されるコネクタ13が取り付けられている。

【0016】このコネクタ13には、超高感度固体撮像 素子2及び固体撮像素子3に入出力される信号を伝送す るための第1と第2の信号ケーブル15,16と、照明 用ライトガイドファイババンドル8の入射端とが挿入部 の先端側から達している。

【0017】ビデオプロセッサ20には、照明用ライト ガイドファイババンドル8に照明光を供給するための例 えばキセノンランプからなる光源ランプ21が配置さ れ、その光源ランプ21と照明用ライトガイドファイバ バンドル8の入射端との間の照明光路中に、RGB回転 フィルタ22が配置されている。

【0018】RGB回転フィルタ22には、図5にも示 されるように、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の カラーフィルタが各々の間に遮光部を挟んで各々扇状に 形成されており、モータ23によって等速度で回転され **ప**。

【0019】各カラーフィルタが透過する光の波長領域 は次のとおりである。赤(R):580nm~650n m。緑(G):500nm~580nm。青(B):4 00nm~500nm.

【0020】その結果、コネクタ13から照明用ライト ガイドファイババンドル8を経由して、挿入部1の先端 の前方にある被写体が、赤、緑、青の3色の照明光によ って順に繰り返し照明される。

【0021】固体撮像素子3に対する信号伝送を行う第 2の信号ケーブル16は、コネクタ13によって、ビデ 30 オプロセッサ20内の通常画像用ビデオ回路24に接続 されている。

【0022】一方、蛍光透過用フィルタ6が前方に設け られた超高感度固体撮像素子2に対する信号伝送を行う 第1の信号ケーブル15は、コネクタ13によって、ビ デオプロセッサ20内の超髙感度撮像素子コントロール 回路26に接続されている。

【0023】そして、超高感度固体撮像素子2の駆動と 固体撮像素子3の駆動及びRGB回転フィルタ22を回 転させるモータ23の回転とが、タイミング回路25か 40 らの出力信号によって同期をとって制御される。

【0024】その結果、固体撮像素子3においては、い わゆるRGB面順次方式による撮像が行われて、通常画 像用ビデオ回路24において、被写体の通常のカラー映 像信号が得られる。

【0025】一方、超高感度固体撮像素子2で撮像され て超高感度撮像素子コントロール回路26に伝達された 映像信号は、そこで、青色の照明光(波長400ヵmな いし500nm)で被写体が照明されたときの映像信号 だけが抽出される。

[0026] そこで得られる画像は、蛍光透過用フィル タ6を透過することができる波長の光による像だけであ るから、青色の照明光に含まれる波長400ヵmないし 500 nmの励起光によって被写体から励起された蛍光 画像信号が、超高感度撮像素子コントロール回路26で 抽出される。

【0027】ビデオプロセッサ20内の画面合成回路2 8には、超高感度撮像素子コントロール回路26から出 力される蛍光画像信号と通常画像用ビデオ回路24から 出力されるカラー画像信号とが入力され、表示画面切り 換えスイッチ29によって、蛍光画像と通常画像の一方 又は両方をモニタテレビ40に任意に表示することがで きる。50は、それらを磁気記録するための記録装置で ある。

【0028】図2に示される27は、ビデオプロセッサ 20に対して制御用のコマンド等を入力するためのキー ボードである。

【0029】図6は本発明の第2の実施の形態を示して おり、第1の実施の形態の超高感度固体撮像素子2に代 えて、イメージインテンシファイア31を通常のモノク 口固体撮像素子3の前に配置したものである。

【0030】イメージインテンシファイア31の制御回 路32はコネクタ13内に配置されていて、イメージイ ンテンシファイア31の感度を調整するための感度調整 スイッチ33が操作部11に配置されている。

【0031】その他の構成については、超高感度撮像素 子コントロール回路26などがビデオプロセッサ20に 不要な以外、第1の実施の形態と同じなので、第1の実 施の形態と同じ符号を付して、その詳細な説明は省略す ٥.

【0032】この第2の実施の形態のように構成するこ とにより、全体の構造をシンプルにすることができ、感 度スイッチ33によってイメージインテンシファイア3 1の感度を切り換えて、適切な明るさの画像をモニタテ レビ40に表示させることができる。

【0033】なお、以上説明した実施の形態において は、青色のカラーフィルタが透過する400nmないし 500nmの波長の光を励起光として用い、蛍光透過用 フィルタ6が透過する光の波長を520nmないし60 0 nmとしたが、生体組織から励起される営光の波長は 略480nmないし600nmの範囲なので、励起光透 過用のカラーフィルタの透過領域の最大波長を480n 血未満に設定して、蛍光透過用フィルタ6が透過する光 の波長を480 nmないし600 nm程度に設定しても よい。各フィルタの特性をそれに近づけることにより、 観察される蛍光画像の光量ロスが少なくなる。

【発明の効果】本発明によれば、通常の固体撮像素子に 比較して非常に感度のよい超高感度固体撮像素子によっ 50 て、生体から発せられる蛍光による蛍光像を撮像するこ

とができるので、充分に明るい蛍光画像を得ることができ、早期癌などを高確率で発見することができる。

#### 【図面の簡単な説明】


- 【図1】本発明の実施の形態の全体構成の内部構造を示す略示図である。
- 【図2】本発明の実施の形態の全体構成の外観を示す斜 視図である。
- 【図3】本発明の実施の形態の電子内視鏡の挿入部先端の側面断面図である。
- 【図4】本発明の実施の形態の電子内視鏡の挿入部先端 10 面の正面図である。

【図5】本発明の実施の形態のRGB回転フィルタの正面図である。


【図6】本発明の第2の実施の形態の全体構成の内部構造を示す略示図である。

#### 【符号の説明】

- 1 挿入部
- 2 超高感度固体撮像素子
- 4 対物光学系
- 6 蛍光透過用フィルタ
- 20 ビデオプロセッサ

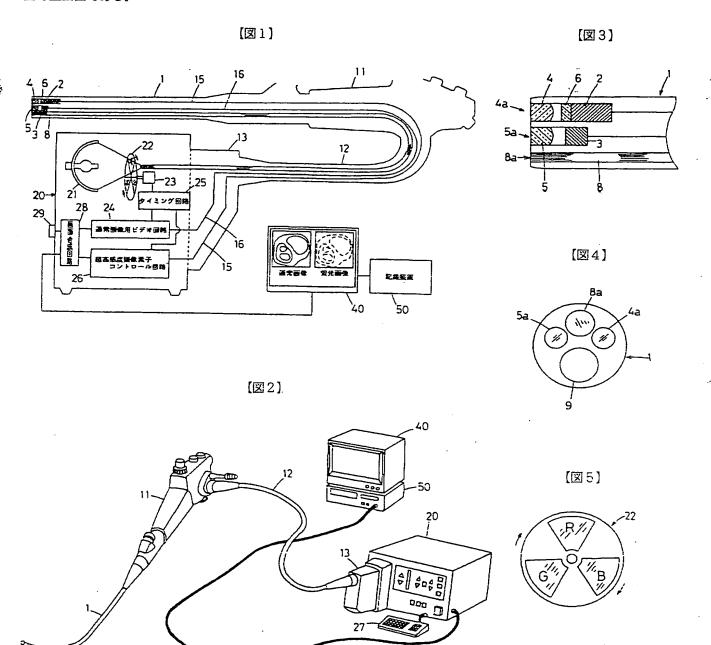



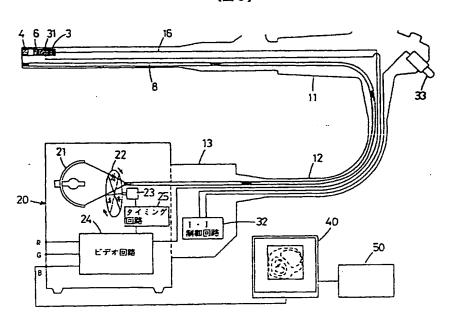

•